
Tjekliste til periodisk eftersyn – DA

Molift Partner 255


molift® by Etac

PI03404 - 2026-06-10 - Rev. 2.0

I overensstemmelse med ISO 10535

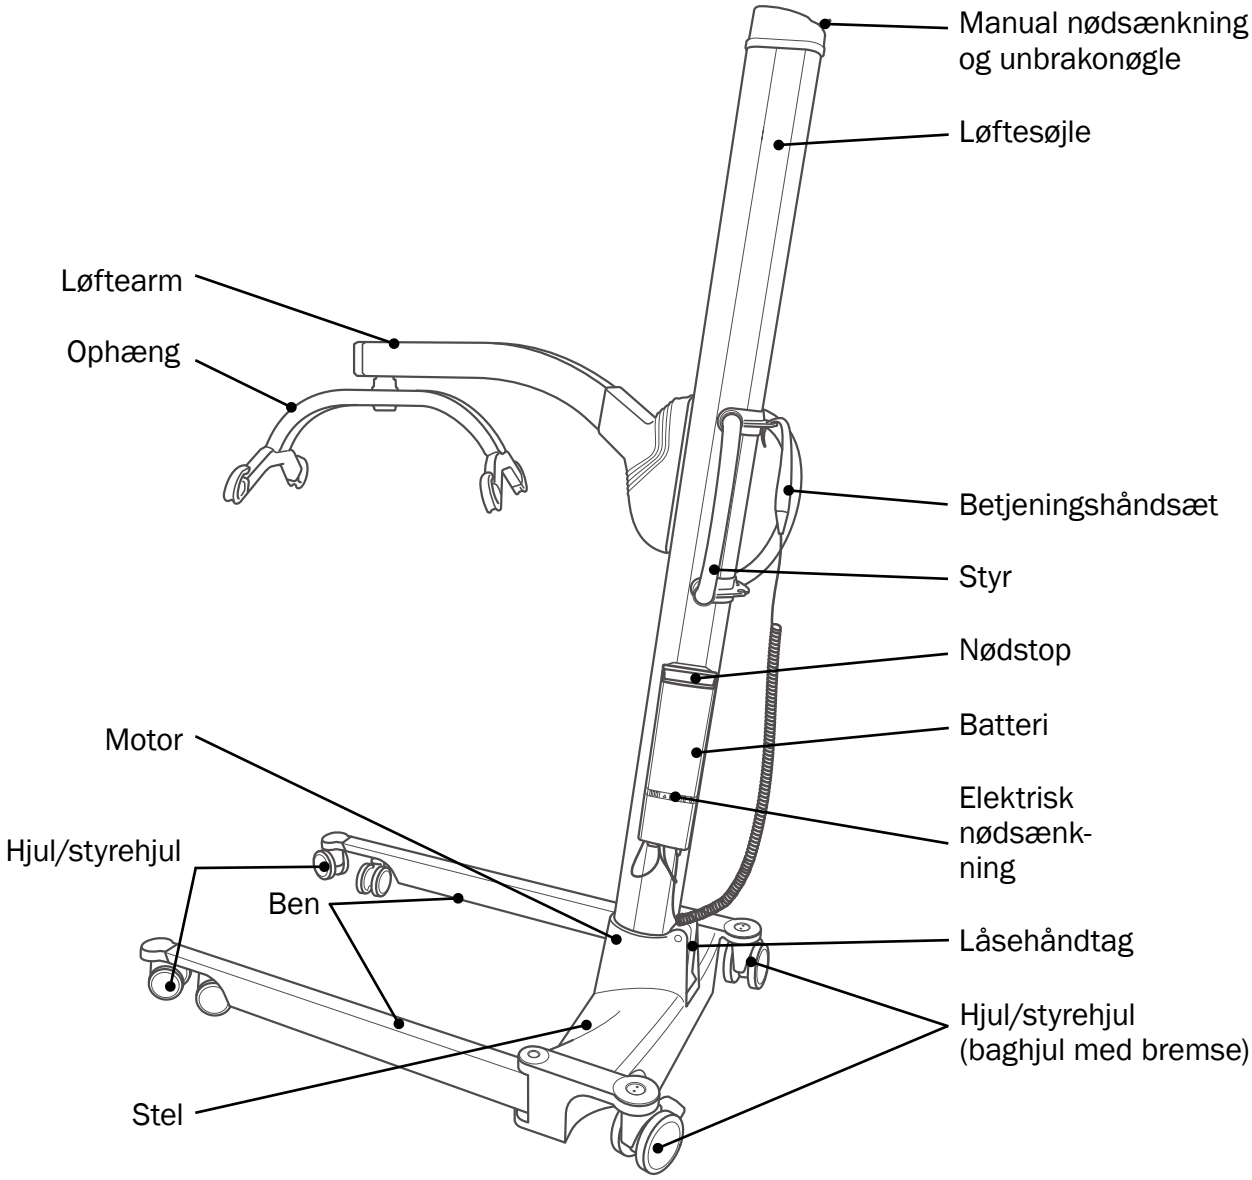


Produktmærkat

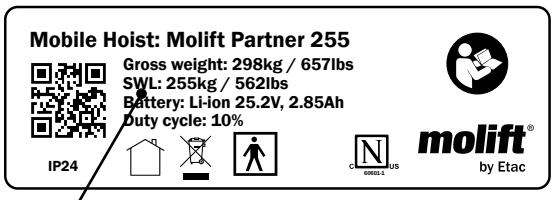

SWL-værdi (sikker arbejdsbelastning)

Id-mærkat

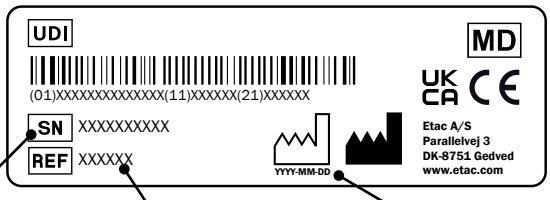

Serienummer Artikelnummer Produktionsdato

En kopi af dette dokument kan downloades på www.etac.com.

Scan QR-koden på produktmærkaten for at få adgang til produktets hjemmeside. Brugervejledningen kan findes i dokumentafsnittet.

Artikelnummer (se id-mærkat):

Serienummer (se id-mærkat):

Produktionsår:

Ejer:

Sejlet skal inspiceres særskilt og er ikke med i dette eftersyn.

Serviceindikatorens lys

Vær opmærksom på farven på serviceindikatorens lys:

Status	*Servicelys*	*Tilstand*
☐	(Intet lys)	Service/Periodisk inspektion er ikke nødvendig
☐	Gul	Bestil service
☐	Gul (blink og lyd ved betjening)	Udfør service
☐	Gul (tænder og slukker langsomt)	Udfør Periodisk Inspektion

Anvendelsessituation

- ☐ Hjemmet
- ☐ Hospital
- ☐ Plejehjem
- ☐ Andet

Det periodiske eftersyn skal udføres af en person, der er egnet og tilstrækkeligt kvalificeret og godt bekendt med konstruktion, brug og pleje af personløfteren

Personløfterens software Molift Service Tool giver mulighed for at indtaste dato for PI og navnet på inspektøren sammen med yderligere oplysninger. Molift anbefaler at tilføje alle observationer/bemærkninger vedrørende personløfteren i Molift Service Tool for at have en komplet historiklog over personløfteren

Visuel undersøgelse

Visuel undersøgelse af den lastbærende struktur for at sikre, at der ikke er skader, revner, flosser eller deformationer. Alle kontrolpunkter skal tjekkes for at godkende personløfter til videre brug

OK	*Ikke OK*	
☐	☐	Løftesøjle
☐	☐	Løftearm
☐	☐	Ben
☐	☐	Produktmærkat
☐	☐	Plastdæksler
☐	☐	Betjeningshåndsæt
☐	☐	Hjul/styrehjul
☐	☐	Oplader
☐	☐	Bremser på hjul/styrehjul
☐	☐	Ledninger
☐	☐	Batteri
☐	☐	Øvrig elektronik
☐	☐	Ophæng
☐	☐	Benjusteringsmekanisme
☐	☐	Ingen korrosion
☐	☐	Svejsninger
☐	☐	Brugsanvisning/ brugervejledning er til stede/ tilgængelig

Funktionel undersøgelse



Test funktion, og inspicer for slitage og skader.
Alle kontrolpunkter skal tjekkes for at godkende personløfter til videre brug

OK	*Ikke OK*	
☐	☐	Hjul/styrehjul
☐	☐	Baghjul/styrehjulets bremser
☐	☐	Med benene i indre position (parallelt): Kontroller, at afstanden mellem benene ikke kan mindskes, når de skubbes sammen med hånden
☐	☐	Løftesøjlen sidder helt fast, når låsehåndtaget er i indgreb
☐	☐	Nødstopknappen er fuldt funktionsdygtig og afbryder strømmen, når den aktiveres. Nulstil afbryder
☐	☐	Værktøj til manuel nødsænkning
☐	☐	Elektrisk nødsænkning
☐	☐	Manuel nødsænkning
☐	☐	Betjeningshåndsæt (knapper, aflastning på betjeningshåndsættets ledning, krog og batteriindikator)
☐	☐	Ophængets kobling (drejeled bevæger sig frit og uden støj)
		Hvis alle punkter indtil videre er *"OK"*, skal personløfteren testes med SWL
☐	☐	Udfør én løftecyklus med vægt, der svarer til SWL (se produktmærkaten for værdi kg/lbs). Motor og aksel må ikke glide under belastning (forårsager at løftearmen sænker sig), og bevægelsen skal være glat og jævn
☐	☐	Benjusteringsmekanisme, ydre og indre position med SWL
☐	☐	Udfør ny visuel kontrol; Skader, slør og deformationer som beskrevet ovenfor. Eventuelle beskadigede dele skal repareres eller udskiftes, og testen gentages endnu en gang, indtil hejsen fungerer korrekt
☐	☐	Opladeren er funktionsdygtig
☐	☐	Nulstil Periodisk inspektion ved at trykke på op- og ned-knapperne på håndbetjeningen i 12 sekunder (efter nulstilling er servicelyset slukket)

Tilbehør:

Udført af

Fulde navn:

Dato/sted:

Underskrift:

☐ Godkendt uden fejl

Næste eftersyn (ÅÅÅÅ/MM): ____/____

☐ Personløfteren er markeret "Ude af drift" og sendt til reparation


☐ Personløfteren er ikke berettiget til reparation og er taget ud af drift


Hvis det periodiske eftersyn afslører en defekt, slitage eller anden skade, der bringer patientens sikkerhed i fare, må personløfteren ikke anvendes, før manglen er afhjulpet

☐ Ejeren er underrettet

Grundet lovkrav skal dette dokument eller en kopi arkiveres sammen med ejerens servicelogbog

Hvis den godkendes uden fejl, påføres inspektionsmærkat, og måned og år til **næste** Periodisk eftersyn noteres herpå. Ved bestilling af mærkat anvendes varenummer 1100306

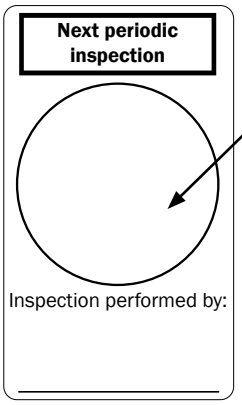



Notér måned og år til næste Periodisk eftersyn på mærkaten

Noter og observationer

UK REP

Etac Ltd.
Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

CH REP

Promefa SA
Avenue de Morges 33
1027 Lonay, CH
+41 44 872 97 79

Etac A/S
Parallelvej 3
DK-8751 Gedved

+45 796 858 33
patienthandling@etac.com
www.etac.com

molift®
by Etac