Molift Quick Raiser 1, 2 och 2+

molift® by Etac

Checklista för periodiska kontroller (SV)

I enlighet med ISO:10535

PI04104 Rev. A 2022-06-13

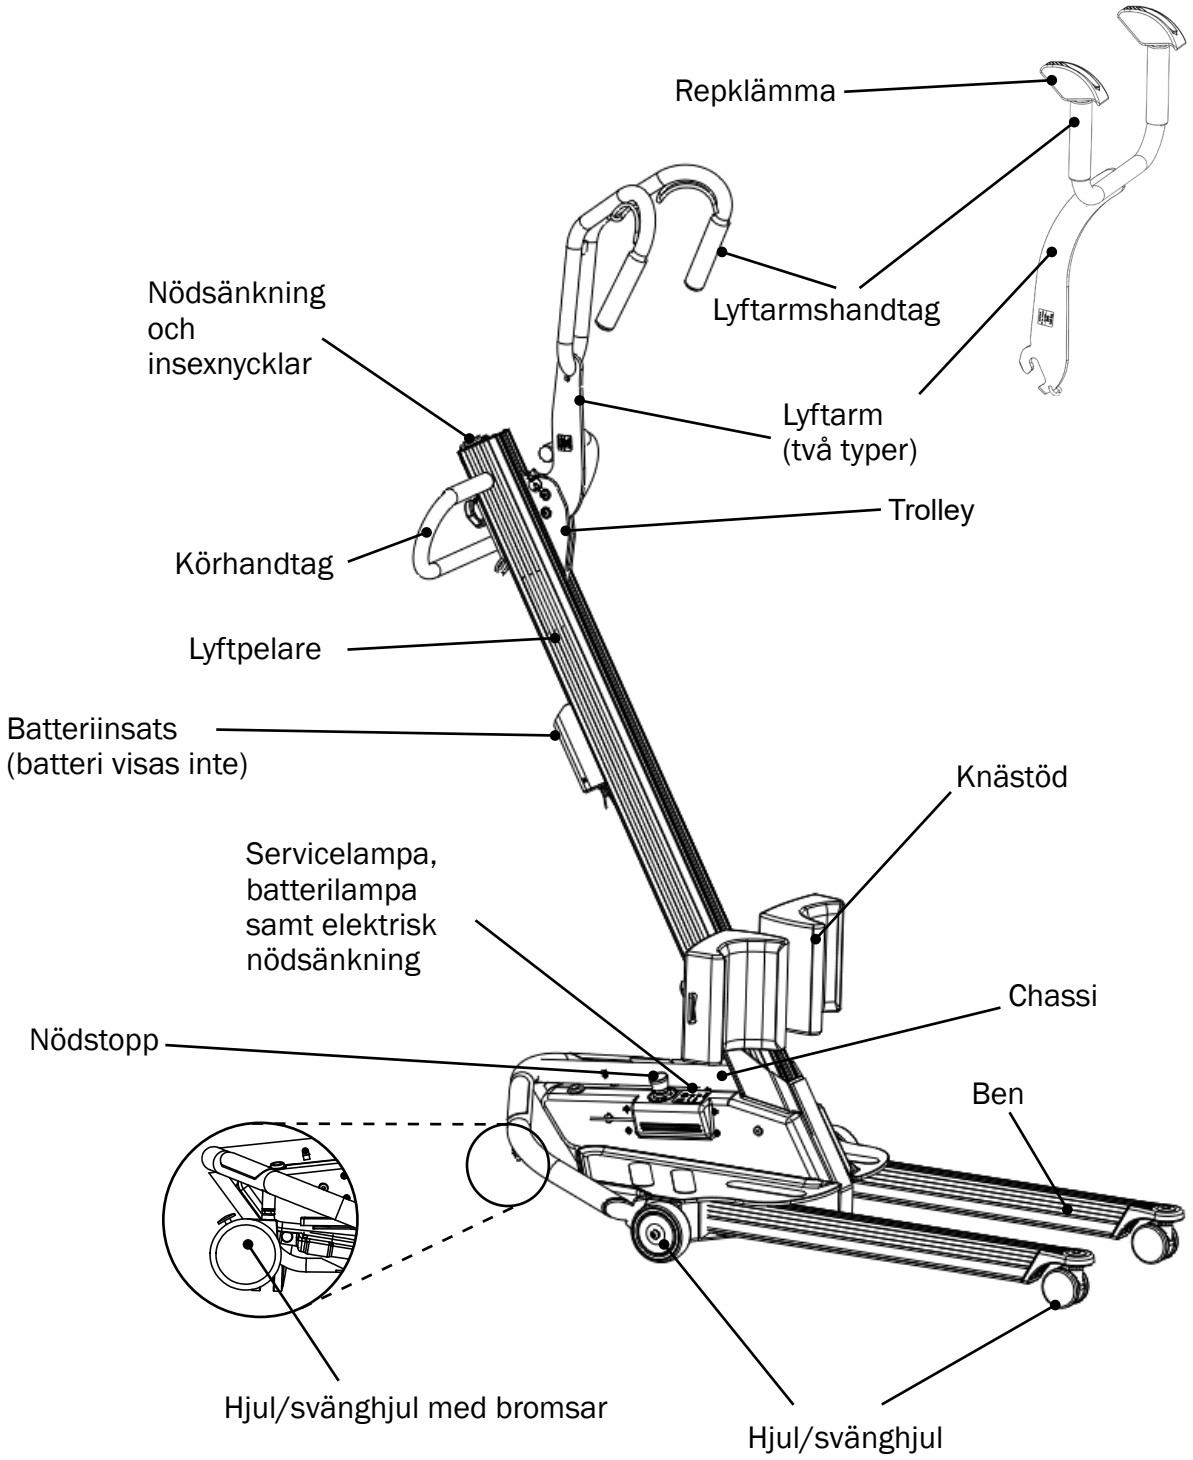

Produktetiketter

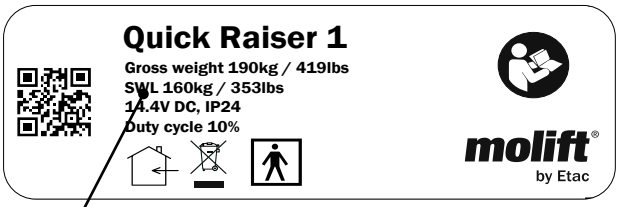

Värde för säker arbetsbelastning

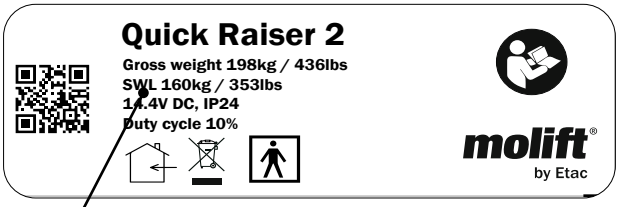

Värde för säker arbetsbelastning

Värde för säker arbetsbelastning

ID-etikett

Serie-nummer

Artikel-nummer

Tillverkningsdatum

Det går att ladda ner det här dokumentet från www.etac.com.

Scanna QR-koden på produktetiketten för att komma till produktens hemsida. Användarmanualen finns under ”Dokument”.

Artikelnummer (se ID-etikett):

Serienummer (se ID-etikett):

Tillverkningsår:

Ägare:

Selen ska inspekteras separat och ingår inte i den här kontrollen.

Specificera modell:

- ☐ Quick Raiser 1
- ☐ Quick Raiser 2
- ☐ Quick Raiser 2+

Serviceljusindikator

Kontrollera serviceljusindikatorns ljus:

Status	*Serviceljus*	*Läge*
☐	Lyser inte	Strömsparläge
☐	Grön	Redo att användas
☐	Gul	Boka service
☐	Röd	Låt utföra service
☐	Röd (plus ljudsignal)	Låt utföra service omedelbart

Användningssituation

- ☐ Hemma
- ☐ Sjukhus
- ☐ Vårdhem
- ☐ Annan

Den periodiska kontrollen ska utföras av en person som är lämpad och kvalificerad samt har kunskap om hur lyften är utformad, används och sköts.

Med lyftens mjukvara Molift Service tool är det möjligt att ange datum när den periodiska kontrollen utförs, namnet på kontrollören samt ytterligare information.
Molift rekommenderar att man skriver in alla observationer/kommentarer rörande lyften i Molift Service tool för att få en komplett historiklogg för lyften.

Visuell undersökning

Visuell undersökning av den bärande strukturen för att säkerställa att det inte finns några skador, sprickor, deformationer eller andra fel. Alla kontrollpunkter ska kontrolleras för att lyften ska godkännas för vidare användning.

OK	*Inte OK*	
☐	☐	Lyftpelare
☐	☐	Lyftarm
☐	☐	Lyftarmsanslutning
☐	☐	Repklämmor
☐	☐	Lyftarmshandtag
☐	☐	Lyftarmsanslutning (trolley)
☐	☐	Ben
☐	☐	Produktetikett
☐	☐	Gummiprofil
☐	☐	Handkontroll
☐	☐	Kontrollpanel
☐	☐	Hjul/svänghjul
☐	☐	Bromsar på hjul/svänghjul
☐	☐	Kablar
☐	☐	Batteri
☐	☐	Laddare
☐	☐	Elektronik
☐	☐	Knästöd
☐	☐	Benspridningsmekanism
☐	☐	Ingen korrosion
☐	☐	Svetsning

OK	*Inte OK*	
☐	☐	Användningsinstruktioner/ användarmanual finns på plats/är tillgänglig

Funktionskontroll

Testa FUNKTIONEN och kontrollera beträffande slitage och skador. Alla kontrollpunkter ska kontrolleras för att lyften ska godkännas för vidare användning.

OK	*Inte OK*	
☐	☐	Hjul/svänghjul
☐	☐	Hjul-/svänghjulsbromsar
☐	☐	Med ben i inre läge (parallella): Kontrollera att det inte går att minska avståndet mellan benen när de trycks ihop för hand.
☐	☐	Nödstoppsknappen fungerar korrekt och bryter strömmen när den trycks ner. Återställ brytaren.
☐	☐	Elektrisk nödsänkning
☐	☐	Verktyg för manuell nödsänkning
☐	☐	Manuell nödsänkning
☐	☐	Handkontroll (alla knappar, dragavlastning på handkontrollens kabel, krok samt batteriindikator)
		Om alla punkter har markerats med ”*OK*” hittills ska lyften testas med säker arbetsbelastning.
☐	☐	Genomför en lyftcykel med vikt som motsvarar 75% säker arbetsbelastning (se produktetiketten för värde i kg/lbs). Motor och axel får inte slira när de belastas (vilket skulle får lyftarmen att sjunka) och rörelsen ska vara mjuk och jämn.
☐	☐	Benspridningsmekanism, yttre och inre position med säker arbetsbelastning

OK	*Inte OK*	
☐	☐	Kontrollera visuellt igen beträffande skador, spel och deformationer så som beskrivs ovan. Alla skadade delar måste repareras eller bytas ut och testet ska göras om tills lyften arbetar korrekt.
☐	☐	Laddaren fungerar.
☐	☐	Batteri. Med fulladdat batteri insatt, efter inledande cykel, batteriljuset är släckt, skiftnyckel-/serviceljusindikatorn är grön

Tillbehör:

Kontroll utförd av

För- och efternamn:

Datum/plats:

Underskrift:

☐ Godkänd utan fel.

Nästa kontroll (ÅÅÅÅ/MM): ____/____

☐ Lyften har klassats som ”fungerar inte” och skickats för reparation.

☐ Lyften kan inte repareras och har tagits ur drift.

Om den periodiska kontrollen visar på defekter, slitage eller andra skador som kan äventyra patientsäkerheten får lyften inte användas förrän bristen har åtgärdats.

☐ Ägaren har informerats.

Till följd av juridiska krav måste det här dokumentet eller en kopia av det arkiveras tillsammans med ägarens serviceloggbok.

Om enheten godkändes utan fel ska kontrolletiketten med markering av år och månad för **nästa** kontroll sättas fast. När du beställer etikett, använd artikelnummer 1100306

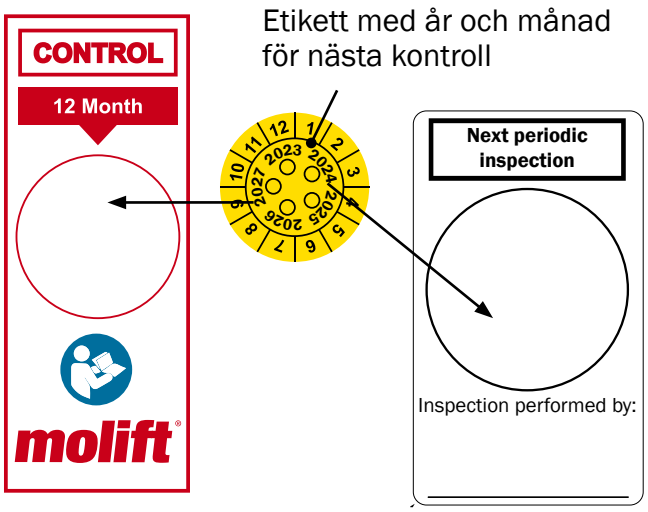

Anteckningar