Lista de verificación de la inspección periódica – ES

Molift Mover 180, 205 y 300

molift® by Etac

PI08210 - 2026-06-10 - Rev. 2.0

De acuerdo con la norma ISO 10535

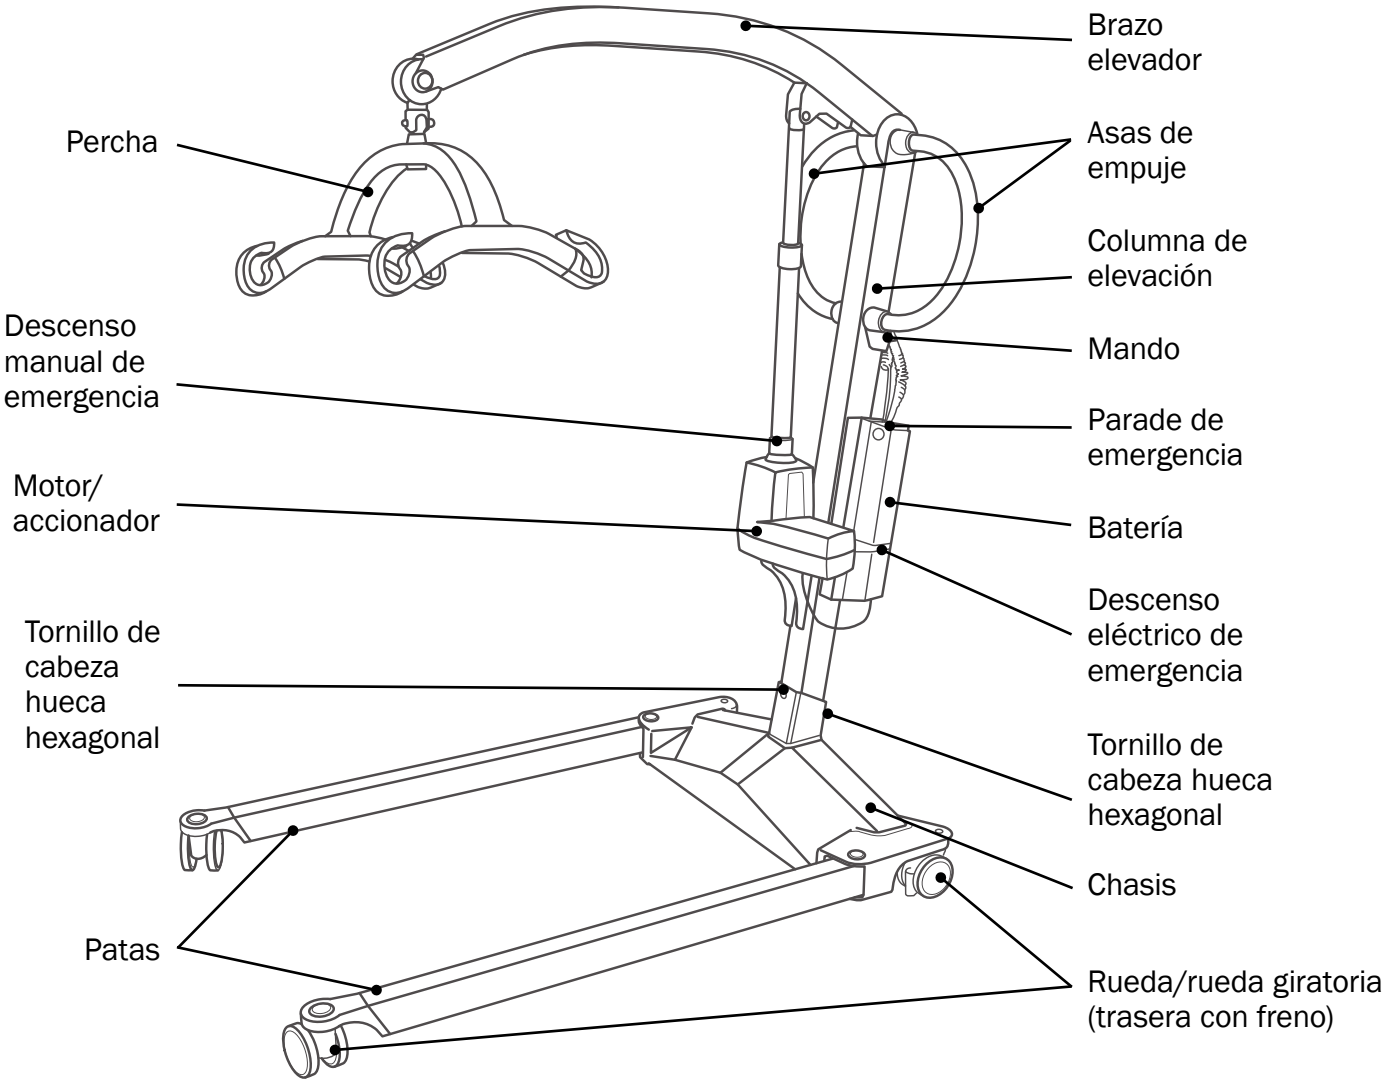

Etiqueta del producto, Mover 180

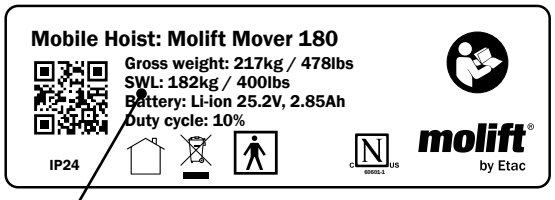

Valor de CTS (Carga de Trabajo Segura)

Etiqueta de identificación, Mover 180

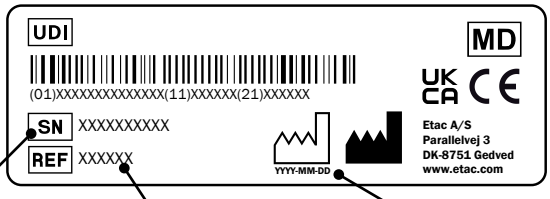

N.º de serie

N.º de artículo

Fecha de producción

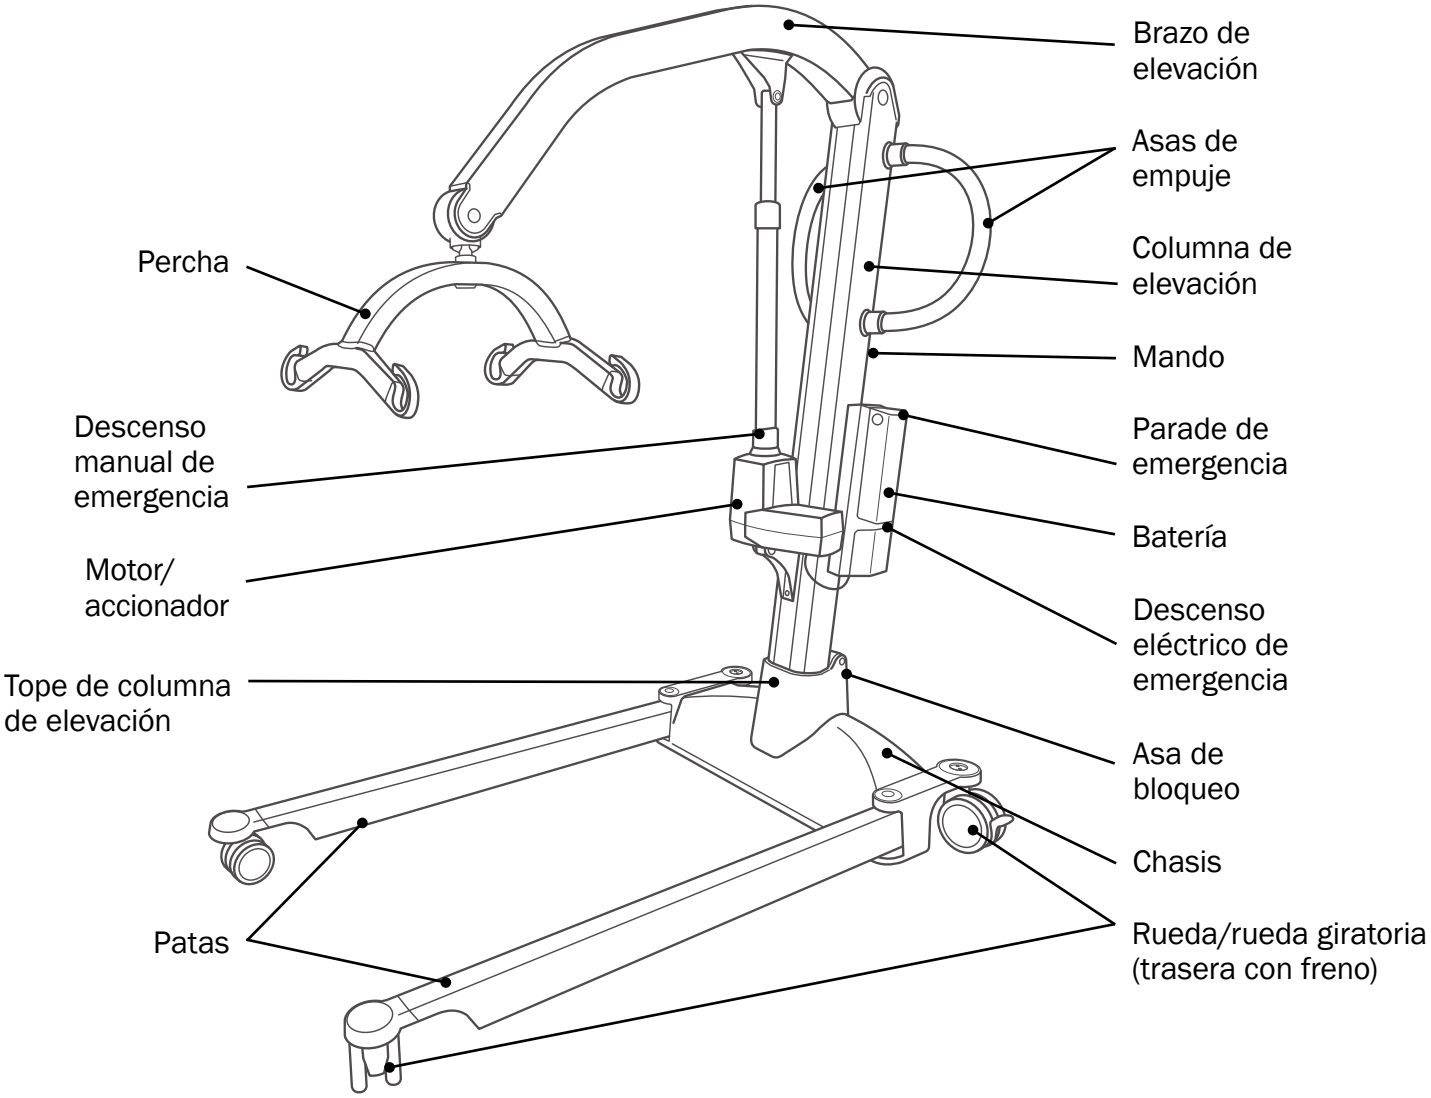

Etiqueta del producto, Mover 205

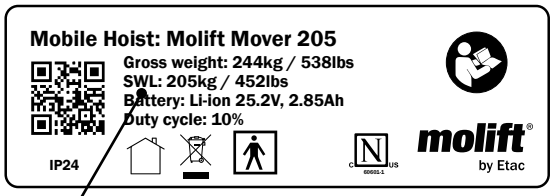

Valor de CTS (Carga de Trabajo Segura)

Etiqueta de identificación, Mover 205

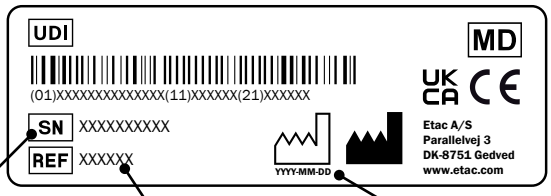

N.º de serie N.º de artículo Fecha de producción

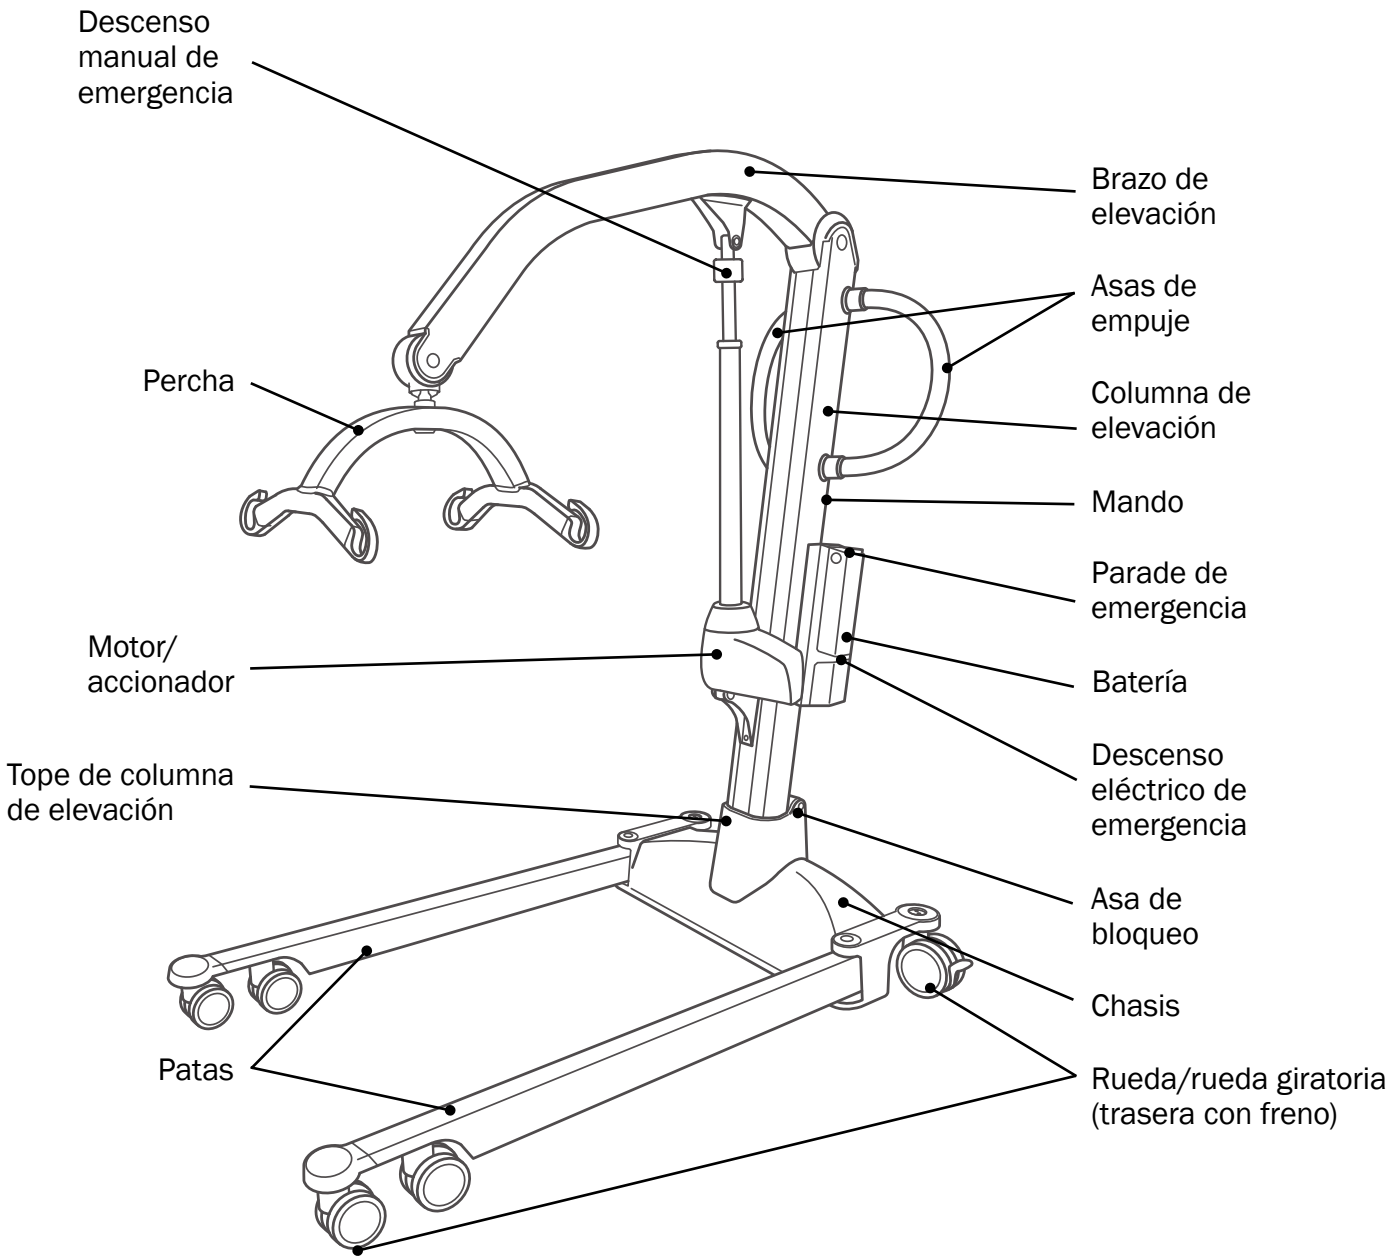

Etiqueta del producto, Mover 300

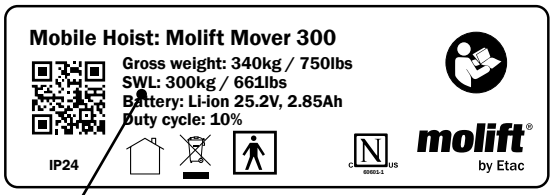

Valor de CTS (Carga de Trabajo Segura)

Etiqueta de identificación, Mover 300

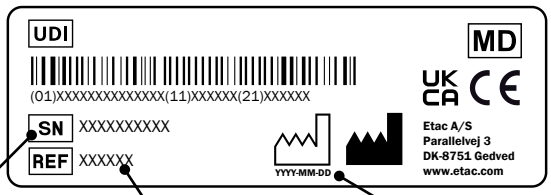

N.º de serie

N.º de artículo

Fecha de producción

Puede descargarse una copia de este documento en www.etac.com.

Escanee el código QR de la etiqueta del producto para acceder a la página de inicio. El manual de usuario se encuentra en la sección de documentos.

N.º de artículo (véase la etiqueta de identificación):

N.º de serie (véase la etiqueta de identificación):

Año de producción:

Propietario:

El arnés debe inspeccionarse por separado y no está incluido en esta inspección.

Especifique el modelo:

Specify model:

- ☐ Mover 180
- ☐ Mover 205
- ☐ Mover 300

Lugar de utilización

- ☐ Hogar
- ☐ Hospital
- ☐ Residencia de ancianos
- ☐ Otro

La inspección periódica debe realizarla una persona debidamente cualificada y que conozca bien el diseño, el uso y el cuidado de la grúa

La herramienta Molift Service del software de la grúa ofrece la opción de introducir la fecha de PI y el nombre del inspector junto con información adicional.
Molift recomienda añadir todas las observaciones/comentarios relativos a la grúa en la herramienta Molift Service para el registro completo del historial de la grúa

Indicador de luz de servicio

Observe el color del indicador luminoso de servicio:

Estado	*Luz de servicio*	*Modo*
☐	(sin luz)	No se requiere servicio/inspección periódica
☐	Amarillo	Pedir servicio
☐	Amarillo (parpadea y suena cuando se acciona)	Realizar mantenimiento
☐	Amarillo (se enciende y apaga lentamente)	Realizar inspecciones periódicas

Examen visual

Examen visual de la estructura para asegurarse de que no hay daños, grietas, deshilachados o deformaciones. Se deben marcar todos los puntos de verificación para aprobar el uso posterior de la grúa

Bien	*No está bien*	
☐	☐	Columna de elevación
☐	☐	Brazo elevador
☐	☐	Patas
☐	☐	Etiqueta del producto
☐	☐	Cubiertas de plástico
☐	☐	Mando
☐	☐	Accionador
☐	☐	Ruedas/ruedas giratorias
☐	☐	Frenos de las ruedas/ruedas giratorias
☐	☐	Cargador
☐	☐	Cables
☐	☐	Batería
☐	☐	Otros componentes electrónicos
☐	☐	Percha
☐	☐	Mecanismo de ajuste de piernas
☐	☐	Sin corrosión
☐	☐	Soldaduras
☐	☐	Las instrucciones de uso/ el manual del usuario están presentes/disponibles

Examen funcional

Compruebe si funciona e inspeccione para detectar si presenta desgaste o daños.
Se deben marcar todos los puntos de verificación para aprobar el uso posterior de la grúa

Bien	*No está bien*	
☐	☐	Ruedas/ruedas giratorias
☐	☐	Frenos de las ruedas/ruedas giratorias traseras
☐	☐	Con las patas en la posición interior (en paralelo): Compruebe que la distancia entre las patas no pueda disminuir al empujarlas con la mano
☐	☐	Solo para Mover 180: La columna de elevación está completamente fijada con tornillos de bloqueo hexagonales bien apretados
☐	☐	Solo para Mover 205 y 300: La columna de elevación está completamente fija cuando se engancha el asa de bloqueo
☐	☐	El botón de parada de emergencia es totalmente operativo e interrumpe el suministro de energía cuando se activa. Botón de reinicio
☐	☐	Descenso eléctrico de emergencia
☐	☐	Descenso manual de emergencia
☐	☐	Mando (botones, alivio de tensión en el cable del mando, gancho e indicador de batería)
☐	☐	Enganche de la percha (la articulación giratoria se mueve libremente y sin hacer ruido)
☐	☐	Desenganche rápido de la percha

Bien	*No está bien*	
		Si todos los puntos se han marcado como “Bien”, la grúa se probará con una CTS (Carga de Trabajo Segura)
☐	☐	Realice un ciclo de elevación con un peso igual a la CTS (Carga de Trabajo Segura) (consulte la etiqueta del producto para conocer el valor en kg/lbs). El actuador no debe deslizarse cuando hay carga (provocando el descenso del brazo de elevación)
☐	☐	Mecanismo de ajuste de piernas, hacia fuera y hacia dentro con CTS (Carga de Trabajo Segura)
☐	☐	Realice un nuevo control visual; Daños, juego y deformaciones como se describió anterior-mente. Cualquier pieza dañada debe ser reparada o sustituida y la prueba se repite una vez más hasta que la grúa funcione correctamente
☐	☐	El cargador está operativo
☐	☐	Reinicie la inspección periódica pulsando los botones de subida y bajada del mando de control durante 12 segundos (después de reiniciar, la luz de servicio se apaga)

Accesorios:

Realizado por

Nombre completo:

Fecha/lugar:

Firma:

☐ Aprobado sin fallos

Próxima inspección
(MM/AAAA): ____/____

☐ La grúa se marca con “Fuera de servicio” y se envía a reparar

☐ La grúa no se puede reparar y se retira del servicio

Si al realizar la inspección periódica se encuentra algún defecto, desgaste u otro daño que pueda poner en peligro la seguridad del paciente, la grúa no podrá utilizarse hasta que se haya subsanado la anomalía.

☐ Se ha notificado al propietario

Por requisitos legales, este documento o una copia del mismo debe archivarse con el libro de registro de servicio del propietario

Si se aprueba sin defectos, coloque la etiqueta de inspección periódica y marque el mes y el año para la **próxima** inspección periódica. Al pedir la etiqueta, utilice el n.º de referencia 1100306

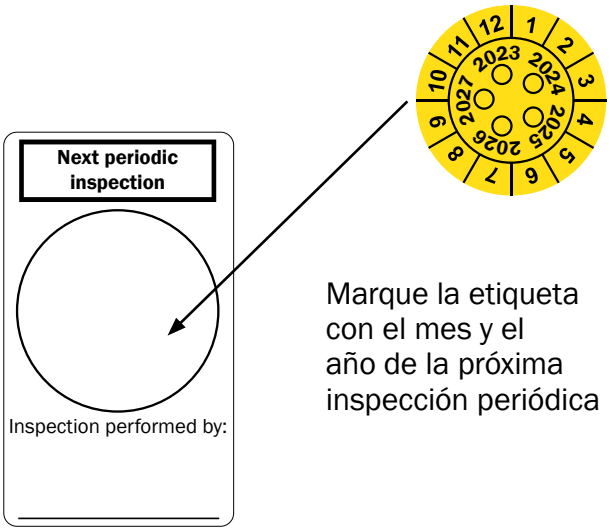

Marque la etiqueta con el mes y el año de la próxima inspección periódica

Notas y observaciones

UK REP

Etac Ltd.
Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

CH REP

Promefa SA
Avenue de Morges 33
1027 Lonay, CH
+41 44 872 97 79

Etac A/S
Parallelvej 3
DK-8751 Gedved

+45 796 858 33
patienthandling@etac.com
www.etac.com

molift®
by Etac