




Prüfliste für die periodische Inspektion (DE) Molift Smart 150


molift[®]
by Etac

PI09506 - 2025-05-01 - Rev. 1.0

Gemäß ISO 10535

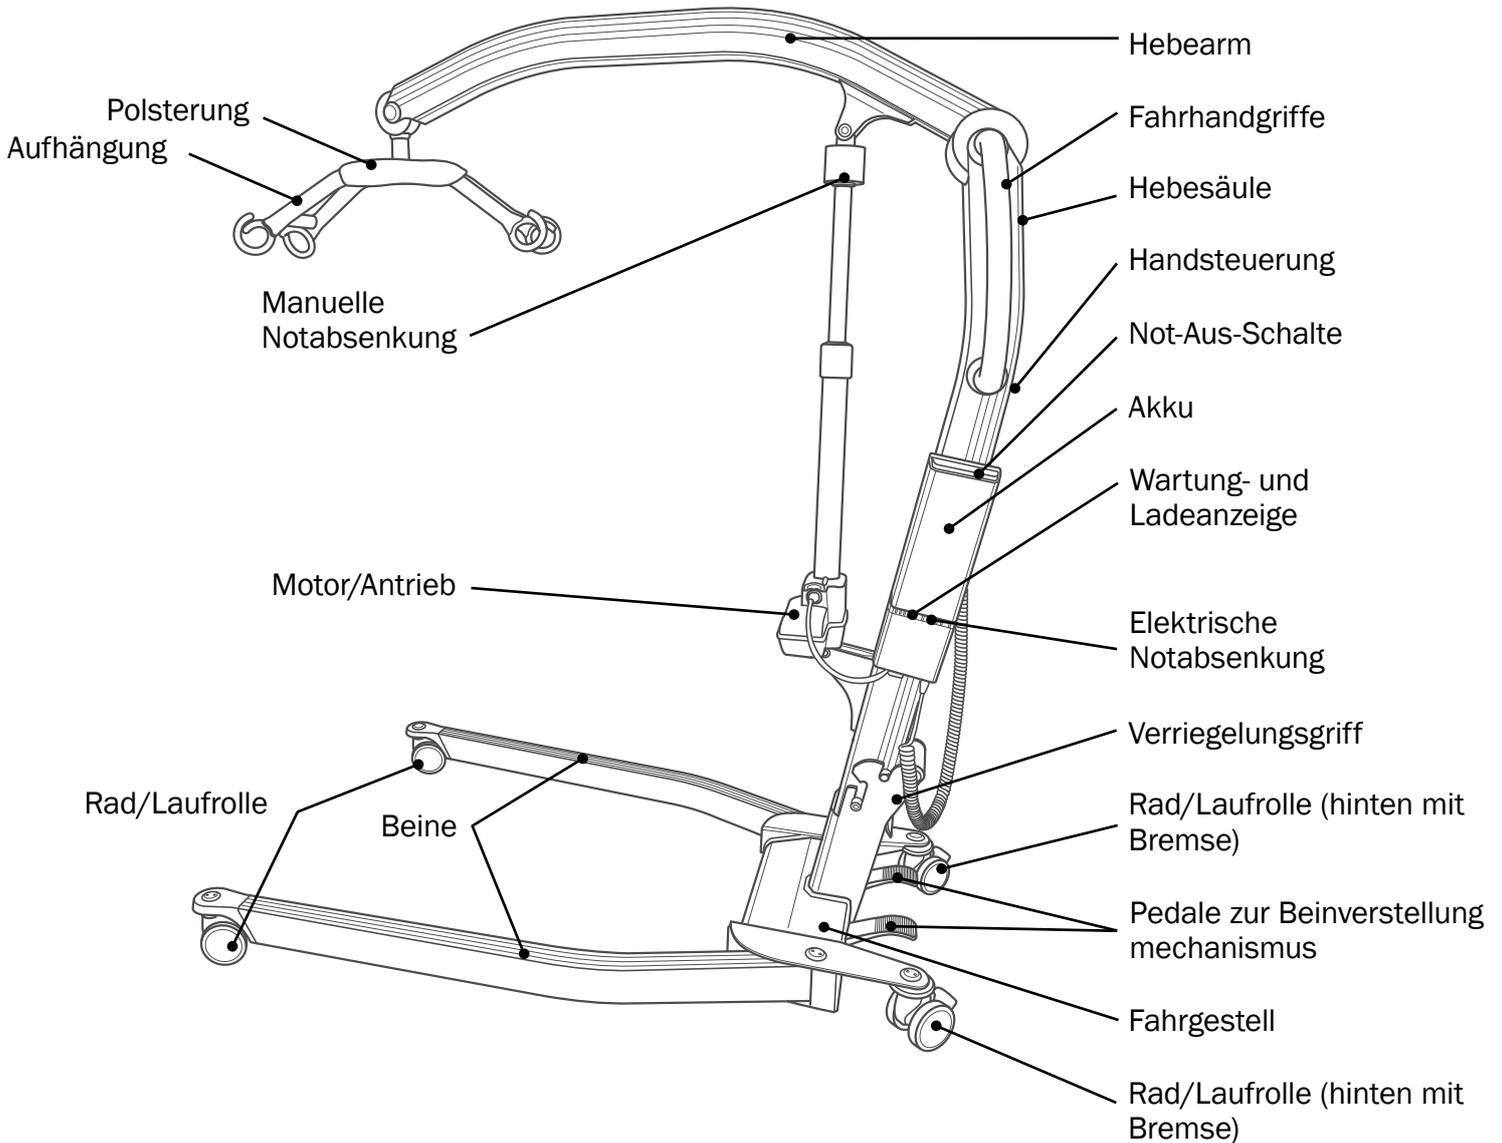


Produktschild

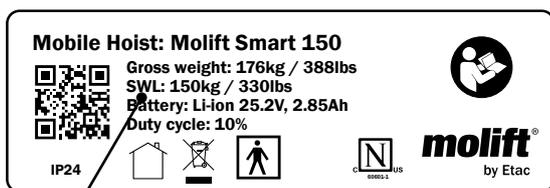

Nenntragfähigkeit

ID-Schild

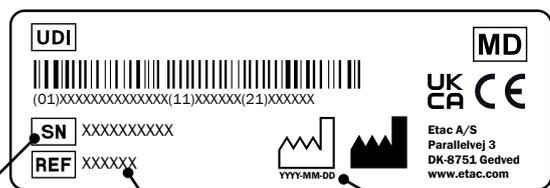

Seriennummer

Artikelnummer

Produktionsdatum

Eine Kopie dieses Dokuments ist unter www.etac.com abrufbar.

Scannen Sie den QR-Code auf dem Produktschild, um zur Produkt-Webseite zu gelangen. Das Benutzerhandbuch finden Sie im Abschnitt „Dokumente“.

Artikelnummer (siehe ID-Schild):

.....

Seriennummer (siehe ID-Schild):

.....

Produktionsjahr:

.....

Eigentümer:

.....

Die Hebegurte müssen gesondert geprüft werden und sind nicht Bestandteil dieser Inspektion.

Wartungslampe

Farbe der Wartungslampe notieren:

Status	Wartungslampe	Modus
	(Kein Licht)	Wartung/regelmäßige Inspektion nicht erforderlich
	Gelb	Wartung beauftragen
	Gelb (blinkt und ertönt bei Betrieb)	Wartung durchführen
	Gelb (schaltet sich langsam ein und aus)	Regelmäßige Inspektion durchführen

Nutzungsumgebung

- Wohnung
- Krankenhaus
- Pflegeheim
- Sonstiges



Die periodische Inspektion muss von einer Person durchgeführt werden, die über die erforderliche Qualifikation verfügt und mit der Konstruktion, der Verwendung und der Pflege des Lifters vertraut ist



Im Molift Service Tool der Lifter-Software können das Datum der regelmäßigen Inspektion, der Name des Technikers und nähere Informationen eingegeben werden. Molift empfiehlt, alle Beobachtungen und Bemerkungen zum Lifter in das Molift Service Tool einzugeben, um ein vollständiges Geräteprotokoll zu gewährleisten

Sichtprüfung



Sichtprüfung der Tragekonstruktion, um Schäden, Risse, Brüche und Verformungen auszuschließen. Alle Prüfpunkte müssen kontrolliert werden, um den Lifter zur weiteren Verwendung zuzulassen

Bestanden	Abgelehnt
	Hebesäule
	Hebearm
	Beine
	Produktschild
	Kunststoffabdeckungen
	Handsteuerung
	Antrieb
	Rad/Laufrolle
	Bremsen an Rad/Laufrolle
	Ladegerät
	Kabel
	Akku
	Sonstige Elektronik
	Aufhängung, mit Polsterung
	Beinverstellung mechanismus
	Keine Korrosion
	Schweißstellen
	Gebrauchsanleitung/ Benutzerhandbuch ist vorhanden/verfügbar

Funktionsprüfung



Prüfen Sie die Funktion und kontrollieren Sie auf Verschleiß und Beschädigung.
Alle Prüfpunkte müssen kontrolliert werden, um den Lifter zur weiteren Verwendung zuzulassen

Bestanden Abgelehnt

Bestanden Abgelehnt

Rad/Laufrolle	<p>Neue Sichtkontrolle durchführen; Beschädigung, Spiel und Verformungen wie oben beschrieben. Alle beschädigten Teile müssen repariert oder ausgetauscht werden, und der Test wird wiederholt, bis der Lifter ordnungsgemäß funktioniert</p> <p>Ladegerät ist betriebsbereit.</p> <p>Die regelmäßige Inspektion zurücksetzen, indem die Aufwärts- und Abwärtstasten auf der Handsteuerung 12 Sekunden lang gedrückt gehalten werden (nach dem Zurücksetzen erlischt die Wartungsanzeige)</p>
Bremsen an hinteren Rad/Laufrolle	
Mit nach innen gedrehtem (parallelem) Bein: Prüfen Sie, dass sich den Beinen von Hand nicht weiter zusammenschieben lässt.	
Die Hebesäule ist vollständig fixiert, wenn der Verriegelungsgriff eingerastet ist	
Die Notabschaltungstaste ist voll funktionsfähig und unterbricht bei Betätigung die Stromzufuhr. Rücksetzschalter	
Elektrische Notabsenkung	
Manuelle Notabsenkung	
Handsteuerung (Tasten, Zugentlastung am Handsteuerungskabel, Haken und Ladeanzeige)	
Aufhängung Kupplung (Drehgelenk bewegt sich frei und geräuschlos)	
Wenn alle obigen Punkte „bestanden“ sind, prüfen Sie die Nenntragfähigkeit des Lifters	
Führen Sie einen Hubvorgang mit einem Gewicht in Höhe der Nenntragfähigkeit durch (siehe Wert in kg/lbs auf dem Produktschild). Der Antrieb darf unter Last nicht durchdrehen (wodurch sich der Hubarm senkt)	
Beinverstellung mechanismus, Drehung nach innen und außen bei Belastung in Höhe der Nenntragfähigkeit	

Zubehör:

.....

.....

.....

Durchgeführt von

Vollständiger Name:

Datum, Ort:

Unterschrift:

.....

Ohne Beanstandungen abgenommen

Nächste Inspektion
(JJJ / MM):/.....

Lifter wird als „defekt“ gekennzeichnet und zur Reparatur geschickt

Lifter ist irreparabel und muss stillgelegt werden.

Werden bei der periodischen Inspektion Mängel, Verschleißerscheinungen oder sonstige Schäden festgestellt, welche die Sicherheit des Pflegebedürftigen gefährden, darf der Lifter bis zur Behebung des Mangels nicht benutzt werden.

Benachrichtigen Sie den Eigentümer.

Anmerkungen und Beobachtungen




Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen muss diese Unterlage oder eine Kopie davon im Wartungsbuch des Besitzers abgelegt werden

Bei einer Genehmigung ohne Mängel den Aufkleber „Regelmäßige Inspektion“ anbringen und Monat und Jahr der **nächsten** regelmäßigen Inspektion eintragen. Verwenden Sie zur Bestellung des Etiketts die Artikelnummer 1100306

Next periodic inspection

Inspection performed by:



Monat und Jahr der nächsten regelmäßigen Inspektion auf dem Aufkleber vermerken

UK REP

Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

CH REP



Sodimed SA

Ch. Praz-Devant 12
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
+41 58 911 06 06



Etac A/S

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac