
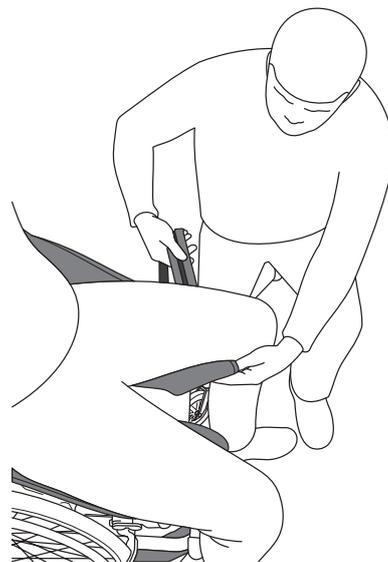


# RgoSling

Bewertungsprotokoll für Liftergurte (DE)

**molift**<sup>®</sup>  
by Etac

UP40002 Rev. A 2023-04-25

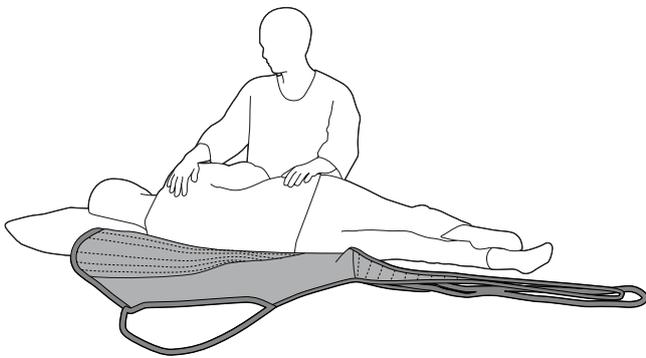

## Inhalt

Inhalt	
Sicherheitshinweise	2
Bewertungsprotokoll RgoSling HighBack/MediumBack	3
Bewertungsprotokoll RgoSling Toilet HighBack/LowBack	4
Bewertungsprotokoll RgoSling Amputee HighBack/MediumBack	5
Bewertungsprotokoll RgoSling StandUp (mit Stützgurt)	6
Bewertungsprotokoll RgoSling Active	7
Bewertungsprotokoll RgoSling Comfort HighBack	8
Bewertungsprotokoll RgoSling Ambulating Vest	9
Bewertungsprotokoll RgoSling Fabric Stretcher	10
Bewertungsprotokoll RgoSling MediumBack Plus	11
Notizen	12

## Sicherheitshinweise

Verwenden Sie das Testprotokoll zusammen mit dem Benutzerhandbuch des jeweiligen Liftergurtes, um diesen individuell zu testen.

 **Lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig die Benutzerhandbücher des Lifters und des Liftergurtes durch.**

Es ist äußerst wichtig, dass der Liftergurt individuell an den vorgesehenen Benutzer und an die vorgesehene Hebesituation angepasst wird, in der der Liftergurt verwendet werden soll.

Entscheiden Sie, ob eine oder mehrere Pflegepersonen benötigt werden.

Planen Sie den Hebevorgang im Voraus, damit sichergestellt ist, dass er so sicher und reibungslos wie möglich abläuft. Nutzen Sie ergonomisch vorteilhafte Arbeitsstellungen.

Schätzen Sie die Risiken ab und machen Sie Notizen. Die Pflegeperson ist für die Sicherheit des Benutzers verantwortlich.

 **Kontrollieren Sie stets:**

- dass der Benutzer in der Lage ist, den Liftergurt zu benutzen
- dass das Modell, die Größe und das Material geeignet sind
- dass es der Liftergurt zulässt, den Hehebügel zu verwenden
- dass die Gurtschlaufen korrekt an den Hehebügelhaken befestigt sind, bevor der Benutzer gehoben wird
- dass die Rollen des Rollstuhls, des Bettes o. Ä. verriegelt sind, falls dies für die Vorgehensweise erforderlich ist



Verwenden Sie niemals einen defekten oder beschädigten Liftergurt, da dieser reißen und Personenschäden verursachen kann. Machen Sie beschädigte und alte Liftergurte unbrauchbar und werfen Sie sie weg.



Der Liftergurt sollte nicht so aufbewahrt werden, dass er direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

### Regelmäßige Inspektion

Mindestens alle sechs Monate muss eine regelmäßige Inspektion durchgeführt werden.

Häufigere Inspektionen können erforderlich sein, falls der Liftergurt häufiger als üblich verwendet oder gewaschen wird. Siehe das Protokoll für die regelmäßigen Inspektionen auf [www.etac.com](http://www.etac.com).



*Besuchen Sie [www.etac.com](http://www.etac.com), um weitere Informationen und Ratschläge zu erhalten und um aktualisierte Dokumentation einzusehen.*

# Bewertungsprotokoll RgoSling HighBack/MediumBack

## Hinweis

Der Liftergurt muss mit dem jeweiligen Benutzer und in der vorgesehenen Hebesituation getestet werden. Ermitteln Sie die bestmögliche Lösung für den Benutzer, indem Sie während des Tests sowohl das Testprotokoll als auch das Benutzerhandbuch für den jeweiligen Liftergurt benutzen.

## Benutzer

Name: .....

Größe (cm): ..... Gewicht (kg): .....

## Produktinformationen

Artikelnummer: .....

Material:  Gepolsterter Polyester  Polyesternetz

Variante:  HighBack (mit Kopfstütze)  MediumBack (ohne Kopfstütze)


Größe:  XXS  XS  S  M  L  XL  XXL

Seriennummer: .....


Hehebügel	Breite	
Vierpunkt-hehebügel	<input type="checkbox"/>	..... (cm)
Zweipunkt-hehebügel	<input type="checkbox"/>	..... (cm)



A Beinhebeschlaufen	1 Rot (extern)	2 Hellgrau	3 Grau	4 Schwarz
Die Beinhebeschlaufen legen den Sitzwinkel des Benutzers und die Druckverteilung fest. Werden die roten Beinhebeschlaufen (1) gewählt, sorgt dies für eine aufrechte Position und für mehr Druck auf den Beinen. Die schwarzen Beinhebeschlaufen (4) sorgen für eine zurückgelehntere Position und für weniger Druck auf den Beinen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




### HighBack

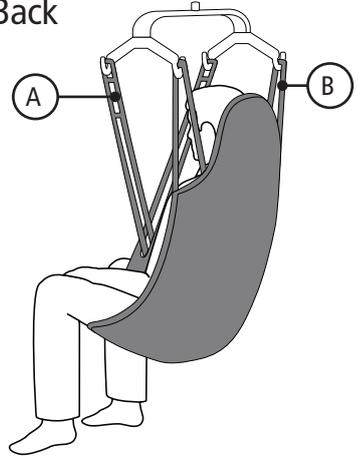

B Obere Hebeschlaufen	
Die Gleitschleife gleicht während des Hebevorgangs die Gewichtsverteilung aus.	

### MediumBack

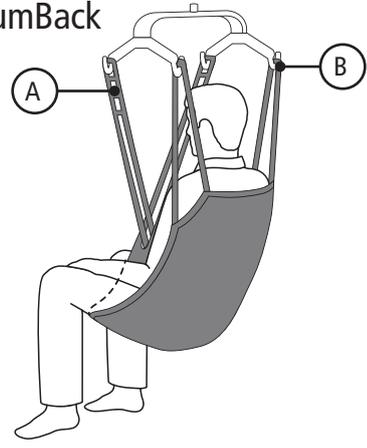

Verbindung der Oberschenkelauflagen	Gekreuzt	Einzel	Gewickelt
Verbinden Sie die Oberschenkelauflagen, wie es für den Hebevorgang am bequemsten und sichersten ist. Wir empfehlen, die Oberschenkelauflagen zu kreuzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Getestete Hebevorgänge	Horizontal	Sitzend
Ausgangsposition. Kreuzen Sie die Hebevorgänge an, die getestet und freigegeben wurden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Endposition. Kreuzen Sie die Hebevorgänge an, die getestet und freigegeben wurden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Der Test und die Risikobewertung wurden durchgeführt von

Name: .....

Datum: ..... Unterschrift: .....

Verwenden Sie einen Permanentmarker. Notieren Sie die erstmalige Verwendung auf dem Etikett und legen Sie ein Datum für die erste regelmäßige Inspektion fest. Notieren Sie den Namen des Benutzers auf dem Etikett – beginnen Sie unten! Der Name kann dann abgeschnitten werden, falls der Liftergurt von einem neuen Benutzer übernommen wird.

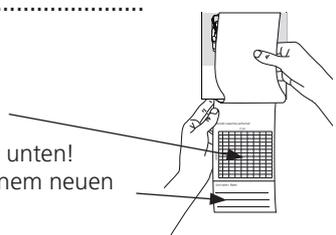

Etac A/S  
 Parallelvej 3  
 8751 Gedved  
 www.etac.com

# Bewertungsprotokoll RgoSling Toilet HighBack/LowBack

## Hinweis

Der Liftergurt muss mit dem jeweiligen Benutzer und in der vorgesehenen Hebesituation getestet werden. Ermitteln Sie die bestmögliche Lösung für den Benutzer, indem Sie während des Tests sowohl das Testprotokoll als auch das Benutzerhandbuch für den jeweiligen Liftergurt benutzen.

## Benutzer

Name: .....

Größe (cm): ..... Gewicht (kg): .....

## Produktinformationen

Artikelnummer: .....

Modell:  HighBack (mit Kopfstütze)  LowBack (ohne Kopfstütze)

Größe:  XXS  XS  S  M  L  XL  XXL

Seriennummer: .....

Hehebügel	Breite	
-----------	--------	--


Vierpunkt-hehebügel  ..... (cm)

Zweipunkt-hehebügel  ..... (cm)




A Beinhebeschlaufen	1 Rot (extern)	2 Hellgrau	3 Grau	4 Schwarz
---------------------	----------------	------------	--------	-----------

Die Beinhebeschlaufen legen den Sitzwinkel des Benutzers und die Druckverteilung fest. Werden die roten Beinhebeschlaufen (1) gewählt, sorgt dies für eine aufrechte Position und für mehr Druck auf den Beinen. Die schwarzen Beinhebeschlaufen (4) sorgen für eine zurückgelehntere Position und für weniger Druck auf den Beinen.



B Obere Hebeschlaufen	1 Rot (extern)	2 Hellgrau	3 Grau	4 Schwarz
-----------------------	----------------	------------	--------	-----------

Die Hebeschlaufen legen den Sitzwinkel des Benutzers und die Druckverteilung fest. Die Hebeschlaufen (4) sorgen für eine aufrechtere Position und für mehr Druck auf den Beinen. Die Hebeschlaufen (1) sorgen für eine zurückgelehntere Position und für weniger Druck auf den Beinen.



C Verbindung der Oberschenkelauflagen	Gekreuzt	Gewickelt	Einzel
---------------------------------------	----------	-----------	--------

Verbinden Sie die Oberschenkelauflagen, wie es am bequemsten und sichersten ist. Wir empfehlen, die Oberschenkelauflagen zu kreuzen. Bei gewickelter oder einzelner Verbindung auf jeder Seite erhöht sich die Gefahr, dass der Benutzer nach vorne aus dem Liftergurt rutscht.

Getestete Hebevorgänge	Sitzend	Toilette
------------------------	---------	----------

Ausgangsposition. Kreuzen Sie die Hebevorgänge an, die getestet und freigegeben wurden.


Endposition. Kreuzen Sie die Hebevorgänge an, die getestet und freigegeben wurden.

## Der Test und die Risikobewertung wurden durchgeführt von


Name: .....

Datum: ..... Unterschrift: .....


Verwenden Sie einen Permanentmarker. Notieren Sie die erstmalige Verwendung auf dem Etikett und legen Sie ein Datum für die erste regelmäßige Inspektion fest. Notieren Sie den Namen des Benutzers auf dem Etikett – beginnen Sie unten! Der Name kann dann abgeschnitten werden, falls der Liftergurt von einem neuen Benutzer übernommen wird.



## HighBack

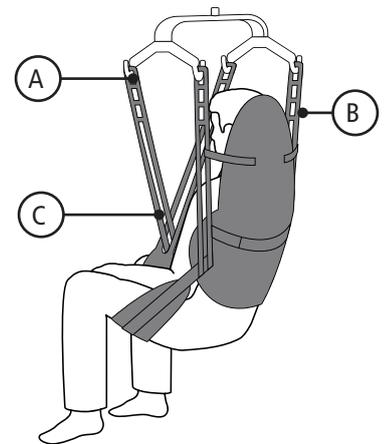

## LowBack

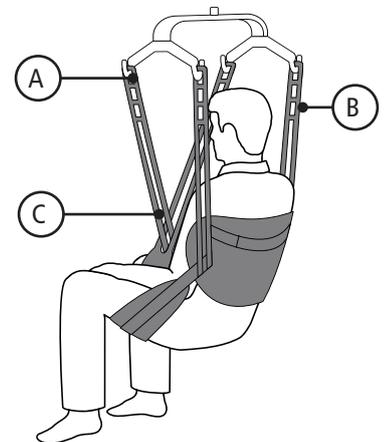

Etac A/S  
 Parallelvej 3  
 8751 Gedved  
 www.etac.com

# Bewertungsprotokoll RgoSling Amputee HighBack/MediumBack

## Hinweis

Der Liftergurt muss mit dem jeweiligen Benutzer und in der vorgesehenen Hebesituation getestet werden. Ermitteln Sie die bestmögliche Lösung für den Benutzer, indem Sie während des Tests sowohl das Testprotokoll als auch das Benutzerhandbuch für den jeweiligen Liftergurt benutzen.

## Benutzer

Name: .....

Größe (cm): ..... Gewicht (kg): .....

## Produktinformationen


Artikelnummer: .....

Modell:  HighBack (mit Kopfstütze)  MediumBack (ohne Kopfstütze)

Größe:  XXS  XS  S  M  L  XL  XXL


Seriennummer: .....

Hehebügel	Breite
Vierpunkt-hehebügel <input type="checkbox"/>	..... (cm)
Zweipunkt-hehebügel <input type="checkbox"/>	..... (cm)




### A Beinhebeschlaufen 1 Rot (extern) 2 Hellgrau 3 Grau 4 Schwarz

Die Beinhebeschlaufen legen den Sitzwinkel des Benutzers und die Druckverteilung fest. Werden die roten Beinhebeschlaufen (1) gewählt, sorgt dies für eine aufrechte Position und für mehr Druck auf den Beinen. Die schwarzen Beinhebeschlaufen (4) sorgen für eine zurückgelehntere Position und für weniger Druck auf den Beinen.




## HighBack

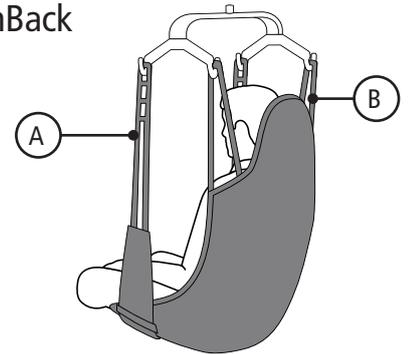

### B Obere Hebeschlaufen Gleitschlaufen Fest angebrachte Schlaufen

Wir empfehlen, Gleitschlaufen zu verwenden, da diese während des Hebevorgangs für eine ausgeglichene Druckverteilung sorgen. Fest angebrachte Schlaufen sorgen stattdessen für eine aufrechte Position.

## MediumBack

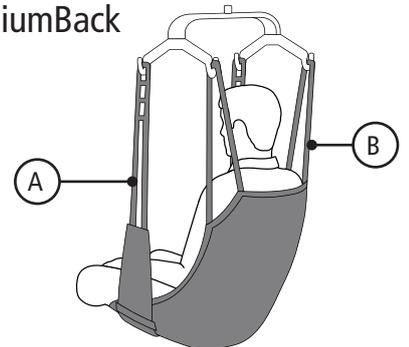


### Verbindung der Oberschenkelauflagen Gewickelt Gekreuzt

Verbinden Sie die Oberschenkelauflagen, wie es für den Hebevorgang am bequemsten und sichersten ist. Wir empfehlen eine gewickelte Verbindung.

### C Taillengurt Mit Taillengurt Ohne Taillengurt

Der Liftergurt kann ohne Taillengurt verwendet werden. Dies birgt jedoch die Gefahr, dass der Benutzer nach vorne fällt. Die Verwendung ohne Taillengurt wird nur bei gekreuzten Oberschenkelauflagen oder einer zurückgelehnten Position empfohlen.

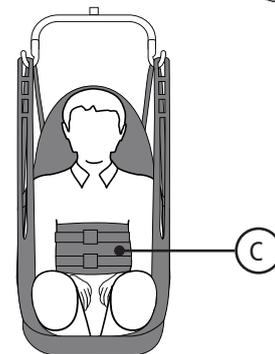

### Getestete Hebevorgänge Horizontal Sitzend

Ausgangsposition. Kreuzen Sie die Hebevorgänge an, die getestet und freigegeben wurden.

Endposition. Kreuzen Sie die Hebevorgänge an, die getestet und freigegeben wurden.

## Der Test und die Risikobewertung wurden durchgeführt von

Name: .....


Datum: ..... Unterschrift: .....

Verwenden Sie einen Permanentmarker.

Notieren Sie die erstmalige Verwendung auf dem Etikett und legen Sie ein Datum für die erste regelmäßige Inspektion fest.

Notieren Sie den Namen des Benutzers auf dem Etikett – beginnen Sie unten!

Der Name kann dann abgeschnitten werden, falls der Liftergurt von einem neuen Benutzer übernommen wird.



Etac A/S  
Parallelvej 3  
8751 Gedved  
www.etac.com

# Bewertungsprotokoll RgoSling StandUp (mit Stützgurt)

## Hinweis

Der Liftergurt muss mit dem jeweiligen Benutzer und in der vorgesehenen Hebesituation getestet werden. Ermitteln Sie die bestmögliche Lösung für den Benutzer, indem Sie während des Tests sowohl das Testprotokoll als auch das Benutzerhandbuch für den jeweiligen Liftergurt benutzen.

## Benutzer

Name: .....

Größe (cm): ..... Gewicht (kg): .....

## Produktinformationen

Artikelnummer: .....


Modell:  StandUp mit Stützgurt (mit unterem Gurt)  StandUp (ohne unteren Gurt)

Größe:  XS  S  M  L  XL


Seriennummer: .....

## Hubarm


V-förmiger Zweipunkt-Hubarm



U-förmiger Zweipunkt-Hubarm



## StandUp

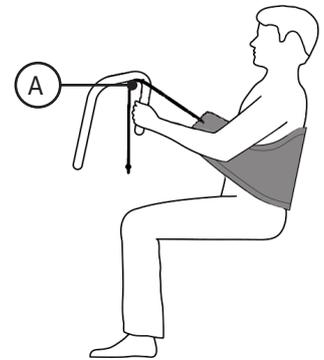

## (A) Hubseile

Der V-förmige Hubarm ist so konstruiert, dass die Hubseile von innen oder von außen befestigt werden können.


Wir empfehlen, bei beleibten Benutzern die Hubseile von außen zu befestigen, da dadurch eine größere Öffnung entsteht.

Stellen Sie sicher, dass die festgezogenen Seile auf beiden Seiten des Benutzers einen gleich langen Überstand haben.

Der Abstand zwischen der rechten und der linken Seite der Polsterung des Taillengurts darf max. 10 cm betragen.

Von innen  Von außen

## StandUp mit Stützgurt

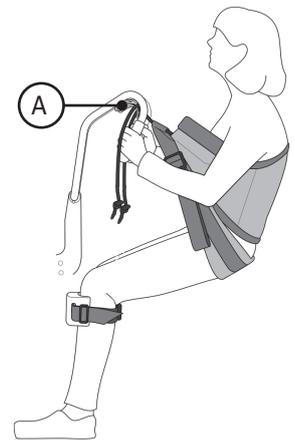

## Getestete Hebevorgänge

Ausgangsposition. Kreuzen Sie die Hebevorgänge an, die getestet und freigegeben wurden.

Sitzend  Toilette

Endposition. Kreuzen Sie die Hebevorgänge an, die getestet und freigegeben wurden.

## Der Test und die Risikobewertung wurden durchgeführt von

Name: .....


Datum: ..... Unterschrift: .....

Verwenden Sie einen Permanentmarker.

Notieren Sie die erstmalige Verwendung auf dem Etikett und legen Sie ein Datum für die erste regelmäßige Inspektion fest.

Notieren Sie den Namen des Benutzers auf dem Etikett – beginnen Sie unten!

Der Name kann dann abgeschnitten werden, falls der Liftergurt von einem neuen Benutzer übernommen wird.



Etac A/S  
 Parallevej 3  
 8751 Gedved  
 www.etac.com

# Bewertungsprotokoll RgoSling Active

## Hinweis

Der Liftergurt muss mit dem jeweiligen Benutzer und in der vorgesehenen Hebesituation getestet werden. Ermitteln Sie die bestmögliche Lösung für den Benutzer, indem Sie während des Tests sowohl das Testprotokoll als auch das Benutzerhandbuch für den jeweiligen Liftergurt benutzen.

## Benutzer



Name: .....

Größe (cm): ..... Gewicht (kg): .....

Taillenumfang (cm): .....


## Hubarm

Vierpunkt-Hubarm

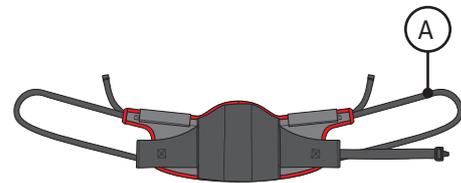

## A Befestigung des Liftergurtes

Befestigen Sie den Liftergurt an allen vier Aufhängungshaken. Stellen Sie sicher, dass die Gurtenden auf beiden Seiten des Benutzers einen gleich langen Überstand haben. Der Abstand zwischen der rechten und der linken Seite der Polsterung des Taillengurtes darf max. 10 cm betragen.

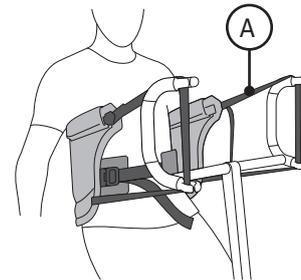

Getestete Hebevorgänge	Sitzend	Toilette
Ausgangsposition. Kreuzen Sie die Hebevorgänge an, die getestet und freigegeben wurden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Endposition. Kreuzen Sie die Hebevorgänge an, die getestet und freigegeben wurden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Der Test und die Risikobewertung wurden durchgeführt von

Name: .....


Datum: ..... Unterschrift: .....

Verwenden Sie einen Permanentmarker.

Notieren Sie die erstmalige Verwendung auf dem Etikett und legen Sie ein Datum für die erste regelmäßige Inspektion fest.

Notieren Sie den Namen des Benutzers auf dem Etikett – beginnen Sie unten!

Der Name kann dann abgeschnitten werden, falls der Liftergurt von einem neuen Benutzer übernommen wird.



Etac A/S  
 Parallelvej 3  
 8751 Gedved  
 www.etac.com

# Bewertungsprotokoll RgoSling Comfort HighBack

## Hinweis

Der Liftergurt muss mit dem jeweiligen Benutzer und in der vorgesehenen Hebesituation getestet werden. Ermitteln Sie die bestmögliche Lösung für den Benutzer, indem Sie während des Tests sowohl das Testprotokoll als auch das Benutzerhandbuch für den jeweiligen Liftergurt benutzen.

## Benutzer

Name: .....

Größe (cm): ..... Gewicht (kg): .....

## Produktinformationen

Artikelnummer: .....

Größe:     XS    S    M    L    XL    XXL



Seriennummer: .....

Hehebügel	Breite	
Vierpunkt-hehebügel	<input type="checkbox"/>	..... (cm)
Zweipunkt-hehebügel	<input type="checkbox"/>	..... (cm)



A Beinhebeschlaufen	1 Rot (extern)	2 Hellgrau	3 Grau	4 Schwarz
Die Beinhebeschlaufen legen den Sitzwinkel des Benutzers und die Druckverteilung des Gewichts fest. Die roten Beinhebeschlaufen (1) sorgen für eine aufrechtere Position. Die schwarzen Beinhebeschlaufen (4) sorgen für eine zurückgelehntere Position und für weniger Druck auf den Beinen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Beinhebeschlaufen legen den Sitzwinkel des Benutzers und die Druckverteilung des Gewichts fest.  
Die roten Beinhebeschlaufen (1) sorgen für eine aufrechtere Position. Die schwarzen Beinhebeschlaufen (4) sorgen für eine zurückgelehntere Position und für weniger Druck auf den Beinen.

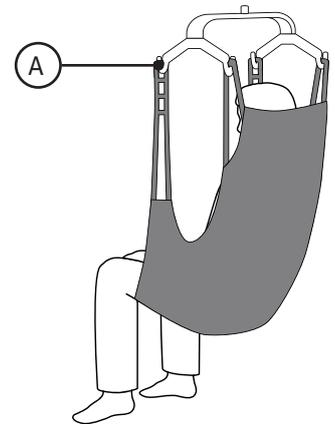

Getestete Hebevorgänge	Horizontal	Sitzend
Ausgangsposition. Kreuzen Sie die Hebevorgänge an, die getestet und freigegeben wurden.	<input type="checkbox"/>	-
Endposition. Kreuzen Sie die Hebevorgänge an, die getestet und freigegeben wurden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ausgangsposition. Kreuzen Sie die Hebevorgänge an, die getestet und freigegeben wurden.

Endposition. Kreuzen Sie die Hebevorgänge an, die getestet und freigegeben wurden.

Hinweis: Der Liftergurt ist so ausgelegt, dass er unter Benutzern verbleibt, die in einem Rollstuhl sitzen.

## Der Test und die Risikobewertung wurden durchgeführt von


Name: .....

Datum: ..... Unterschrift: .....

Verwenden Sie einen Permanentmarker.

Notieren Sie die erstmalige Verwendung auf dem Etikett und legen Sie ein Datum für die erste regelmäßige Inspektion fest.

Notieren Sie den Namen des Benutzers auf dem Etikett – beginnen Sie unten!  
Der Name kann dann abgeschnitten werden, falls der Liftergurt von einem neuen Benutzer übernommen wird.



Etac A/S  
Parallevej 3  
8751 Gedved  
www.etac.com

# Bewertungsprotokoll RgoSling Ambulating Vest

## Hinweis

Der Liftermantel muss mit dem jeweiligen Benutzer und in der vorgesehenen Hebesituation getestet werden. Ermitteln Sie die bestmögliche Lösung für den Benutzer, indem Sie während des Tests sowohl das Testprotokoll als auch das Benutzerhandbuch für den jeweiligen Liftermantel benutzen.

## Produktinformationen

Artikelnummer: .....

Größe:    XXS   XS   S   M   L   XL

Seriennummer: .....

## Benutzer


Name: .....

Größe (cm): .....    Gewicht (kg): .....

### Hehebügel                      Breite



Vierpunkt-  
hehebügel     ..... (cm)

Zweipunkt-  
hehebügel     ..... (cm)



### (A) Hebeschlaufen                      ① Rot (extern)    ② Hellgrau    ③ Grau    ④ Schwarz

Verwenden Sie für alle vier Hebeschlaufen die gleiche Höhe/Farbe.                                                                                       

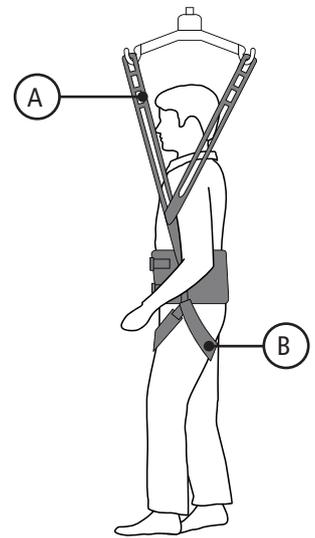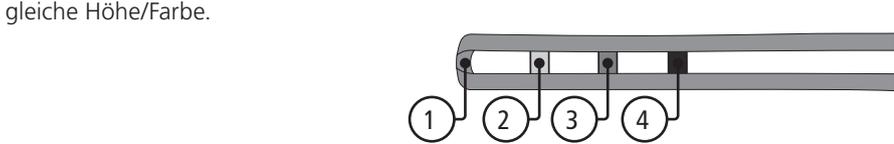

### (B) Leistengurt                      Keiner                      Größe

Leistengurt                                            XXS-XS    S-M    L-XL

### Getestete Hebevorgänge                      Sitzend                      Toilette

Ausgangsposition. Kreuzen Sie die Hebevorgänge an, die getestet und freigegeben wurden.                                           

Endposition. Kreuzen Sie die Hebevorgänge an, die getestet und freigegeben wurden.                                           

### Therapie/Training                      Gangtraining                      Stehen


Kreuzen Sie die Hebevorgänge an, die getestet und freigegeben wurden.                                           

## Der Test und die Risikobewertung wurden durchgeführt von

Name: .....

Datum: .....    Unterschrift: .....

Verwenden Sie einen Permanentmarker.  
Notieren Sie die erstmalige Verwendung auf dem Etikett und legen Sie ein Datum für die erste regelmäßige Inspektion fest.  
Notieren Sie den Namen des Benutzers auf dem Etikett – beginnen Sie unten!  
Der Name kann dann abgeschnitten werden, falls der Liftermantel von einem neuen Benutzer übernommen wird.



Etac A/S  
Parallelvej 3  
8751 Gedved  
www.etac.com



# Bewertungsprotokoll RgoSling MediumBack Plus

## Hinweis

Der Liftergurt muss mit dem jeweiligen Benutzer und in der vorgesehenen Hebesituation getestet werden. Ermitteln Sie die bestmögliche Lösung für den Benutzer, indem Sie während des Tests sowohl das Testprotokoll als auch das Benutzerhandbuch für den jeweiligen Liftergurt benutzen.

## Benutzer

Name: .....

Größe (cm): ..... Gewicht (kg): .....

## Produktinformationen

Artikelnummer: .....


Größe:  L  XL

Seriennummer: .....

### Hebebügel Breite


Vierpunkt-hebebügel  550 cm  650 cm

Vierpunkt-Stahlhebebügel  Einheitsgröße



### (A) Obere Hebeschlaufen ① Rot (extern) ② Hellgrau ③ Grau ④ Schwarz

Die Hebeschlaufen legen den zurückgelehnten Sitzwinkel des Benutzers und die Druckverteilung fest.

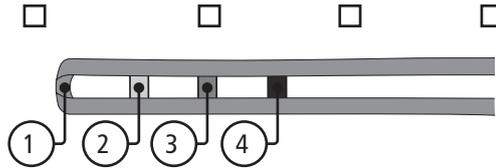

### (B) Zentrale Beinschlaufen ① Rot (extern) ② Hellgrau ③ Grau ④ Schwarz

Die zentralen Beinschlaufen können je nach den Bedürfnissen des Benutzers gekreuzt werden (Abb. 1) oder einzeln angebracht werden (Abb. 2).

### (C) Äußere Beinschlaufen ① Rot (extern) ② Hellgrau ③ Grau ④ Schwarz

Wählen Sie die Beinschlaufenkombination, die zu den individuellen Bedürfnissen passt.

### Verbindung der zentralen Beinschlaufen Gekreuzt Einzeln


Die zentralen Beinschlaufen können je nach den Bedürfnissen des Benutzers gekreuzt werden (Abb. 1) oder einzeln angebracht werden (Abb. 2).

### Getestete Hebevorgänge Horizontal Sitzend


Ausgangsposition. Kreuzen Sie die Hebevorgänge an, die getestet und freigegeben wurden.

Endposition. Kreuzen Sie die Hebevorgänge an, die getestet und freigegeben wurden.

**Abb. 1:**  
Gekreuzt

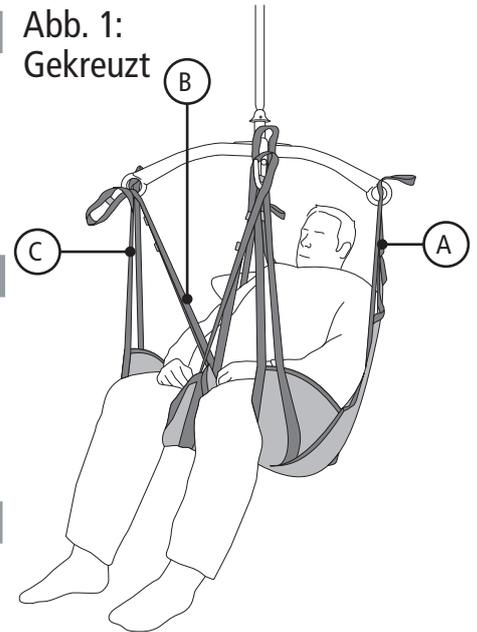

**Abb. 2:**  
Einzeln

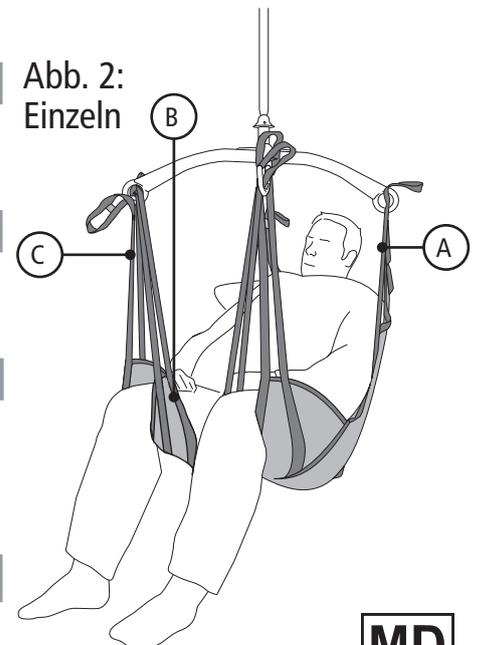

## Der Test und die Risikobewertung wurden durchgeführt von

Name: .....

Datum: ..... Unterschrift: .....

Verwenden Sie einen Permanentmarker.

Notieren Sie die erstmalige Verwendung auf dem Etikett und legen Sie ein Datum für die erste regelmäßige Inspektion fest.

Notieren Sie den Namen des Benutzers auf dem Etikett – beginnen Sie unten!

Der Name kann dann abgeschnitten werden, falls der Liftergurt von einem neuen Benutzer übernommen wird.



Etac A/S  
Parallelvej 3  
8751 Gedved  
www.etac.com







Etac A/S  
Parallevej 3  
DK-8751 Gedved  
[www.etac.com](http://www.etac.com)

***molift***<sup>®</sup>  
by Etac